

INSO
16331
1st.Edition
May.2013



استاندارد ملی ایران

۱۶۳۳۱

چاپ اول

اردیبهشت ۱۳۹۲

میکروسکوپ‌ها - گراتیکول‌ها برای عدسی‌های چشمی

Microscopes — Graticules for eyepieces

ICS:37.020

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازهٔ شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« میکروسکوپ‌ها - گراتیکول‌ها برای عدسی‌های چشمی »

سمت و / یا نمایندگی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز

رئیس:

صالحی، حمدالله
(دکتری فیزیک)

کارشناس

دبیر:

پولادزاده، آذردخت
(لیسانس فیزیک)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سرپرست تعمیرات لایه آزمائی
شرکت ملی حفاری

بازفتی، مراد

(فوق لیسانس نفت)

کارشناس

پولادزاده، احمد
(لیسانس برق)

کارشناس

پولادزاده، اعظم
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس

توسلی، رویا

(لیسانس چوب)

کارشناس تعمیرات پتروشیمی
فن آوران ماهشهر

جلالی، شیرزاد
(لیسانس مکانیک)

کارشناس تدوین اداره کل
استاندارد خوزستان

چراغی، حسین

(فوق لیسانس متالورژی)

خوشنام، فرزانه
کارشناس تدوین اداره کل
استاندارد خوزستان
(فوق لیسانس شیمی)

فانی، الهام
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اهواز
(فوق لیسانس فیزیک)

کریمی بیرگانی، کاوه
کارشناس
(لیسانس شیمی صنایع پتروشیمی)

مهرمولاوی، فاطمه
کارشناس تدوین اداره کل
استاندارد خوزستان
(فوق لیسانس شیمی آلی)

پیش گفتار

استاندارد "میکروسکوپ‌ها- گراتیکول‌ها برای عدسی‌های چشمی" که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در سیصد و هجدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۰/۱۲/۱۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 9344: 2011, Microscopes - Graticules for eyepieces

میکروسکوپ‌ها - گراتیکول‌ها برای عدسی‌های چشمی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها از جمله ابعاد و نقایص مجاز ماده و خرابی‌های عملیاتی برای گراتیکول‌ها^۱ با قطرهای ۱۹mm، ۲۱mm و ۲۶mm مورد استفاده در عدسی‌های چشمی میکروسکوپ می‌باشد.

این استاندارد برای عدسی‌های چشمی میکروسکوپ به منظور اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که مدرکی با ذکر تاریخ ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظراست.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۳۷-۳، اپتیک و تجهیزات اپیتکی- رسم نقشه‌های قطعات و سیستم‌های اپتیکی- قسمت ۳- نقایص ماده - حباب‌ها و ناخالصی‌ها

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۳۷-۴، اپتیک و تجهیزات اپیتکی- رسم نقشه‌های قطعات و سیستم‌های اپتیکی- قسمت ۴- نقایص ماده - ناهمگنی و خش‌ها

2-3 ISO 10110-1:2006, Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 1: General

2-4 ISO 10110-5:2007, Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 5: Surface form tolerances

2-5 ISO 10110-7:2008, Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 7: Surface imperfection tolerances

2-6 ISO 10110-8:2010, Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 8: Surface texture; roughness and waviness

۳ الزامات

۱-۳ ابعاد گراتیکول‌های نوع ۱ و نوع ۲ در جدول ۱ مشخص شده است.

جدول ۱- ابعاد گراتیکول‌ها

نوع ۲	نوع ۱	پارامتر
$19_{-0.033}^0$	$19_{-0.1}^0$	قطر ^a ، d
$21_{-0.033}^0$	$21_{-0.1}^0$	
$26_{-0.033}^0$	$26_{-0.1}^0$	
1.0	1.0	ضخامت
1.5	1.5	
0.3 تا 0.1	0.3 تا 0.1	پنج محافظ مطابق استاندارد ISO 10110-1

^a قطرهای دیگر در صورتی که با ضخامت‌های مشخص شده و الزامات فهرست شده در جدول ۲ مطابق باشند، مجاز هستند.


۲-۳ نقایص مجاز ماده و خرابی‌های عملیاتی

ابعاد برای گراتیکول‌های نوع ۱ و نوع ۲ در جدول ۲ مشخص شده است.

۴ نشانه‌گذاری

برای متمایز کردن گراتیکول نوع ۱ که به طور معمول استفاده می‌شود از رواداری کوچک‌تر گراتیکول نوع ۲، نشانه‌گذاری "نوع ۲ مطابق با استاندارد ISO 9344" است" باید روی خود گراتیکول یا روی بسته‌بندی گراتیکول قرار گیرد.

جدول ۲- نتایج مجاز ماده و خرابی‌های عملیاتی

حداکثر الزامات	ناحیه آزمون ^a	مرجع برای ویژگی ها	معیار
$1/2 \times 0,016^b$	۱	استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۳۷-۳	حباب
$1/2 \times 0,025^b$	۲	استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۳۷-۴	خش‌ها
$2/-; 3^c$	-	استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۳۷-۴	خطاهای شکلی سطح
$3/6 (3)^d$	-	ISO 10110-5	
$5/2 \times 0,016^b; L_2 \times 0,025^e$	۱	استاندارد ۷ ISO 10110-7	عیب‌های سطح برای هر وجه
$5/2 \times 0,025^b; L_2 \times 0,004^e$	۲		
	-	استاندارد ۸ ISO 10110-8	کیفیت سطح
≤ 10	-	-	رواداری موازی بودن

^a برای مشاهده تصویری از ناحیه آزمون شکل ۱ را ببینید.

^b کد برای عیب تقسیم بر تعداد مجاز عیب‌ها ضرب در ریشه دوم حداکثر سطح بزرگ‌ترین عیب، بر حسب میلی‌متر مربع (mm^2)
برای مثال، $1/2 \times 0,1$ نشان دهنده ۲ عیب حبابی با حداکثر سطح $0,01 mm^2$ به ازای هر حباب است.

^c خط تیره بعد از کد عیب، نشان می‌دهد که ناهمگنی مشخص نشده است، رقم ۳ نشان دهنده کلاس خش‌هاست، که مجاز است مساحت‌های مؤثر زیر نسبت به قطر صفحه گراتیکول دارا باشد:


۲۶	۲۱	۱۹	قطر، میلی‌متر
۳	۳	۳	کلاس خش‌ها
۱۰	۶	۵	مساحت خش‌ها، میلی‌متر مربع

^d مطابق استاندارد ISO 10110-5، اولین عدد بعد از کد عیب نشان دهنده عدد فرانزهای تداخلی است، در حالی که عدد داخل کروشه انحراف مجاز از تقارن چرخشی را نشان می‌دهد (تعداد فاصله‌های فرانز).

^e دو خراش طویل (L) با طول نامشخص و حداکثر عرض $0,004 mm$ ($0,0025 mm$) مجاز هستند.

^f سطح صیقلی با کمتر از ۱۶ نقص ریز به ازای هر $10 mm$ خط اسکن

بعد بر حسب میلی متر

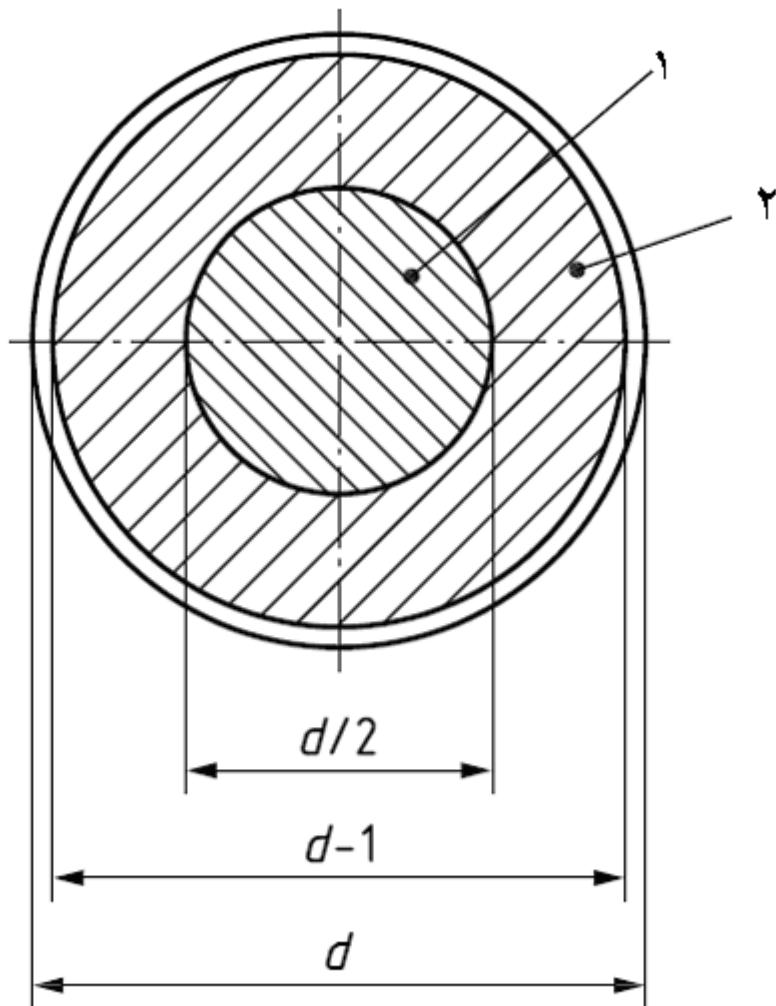

راهنمای:

- | | |
|---|---------------|
| ۱ | ناحیه آزمون ۱ |
| ۲ | ناحیه آزمون ۲ |

شکل ۱- نواحی آزمون